



# 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1

2 术语和定义 .....	1
---------------	---

附录 参考文献 .....	2
---------------	---

# 前 言

本标准自“直接冲积层及冲积层”开始制定 决不制定冲积层上部的其他冲积层

# 湿热试验箱技术条件

## 1 范围

本标准规定了湿热试验箱(以下简称试验箱)的技术条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全和环保要求。



1.3 适用于... 的... 的...

6.2 供水条件

a) 水压:  $220 \text{ V} \pm 22 \text{ V}$  或  $200 \text{ V} \pm 20 \text{ V}$

b) 频率:  $50 \text{ Hz} \pm 0.5 \text{ Hz}$ 。

6.2 供水条件


a) 冷却水

宜使用满足下列条件的自来水循环水

--

类 别

--

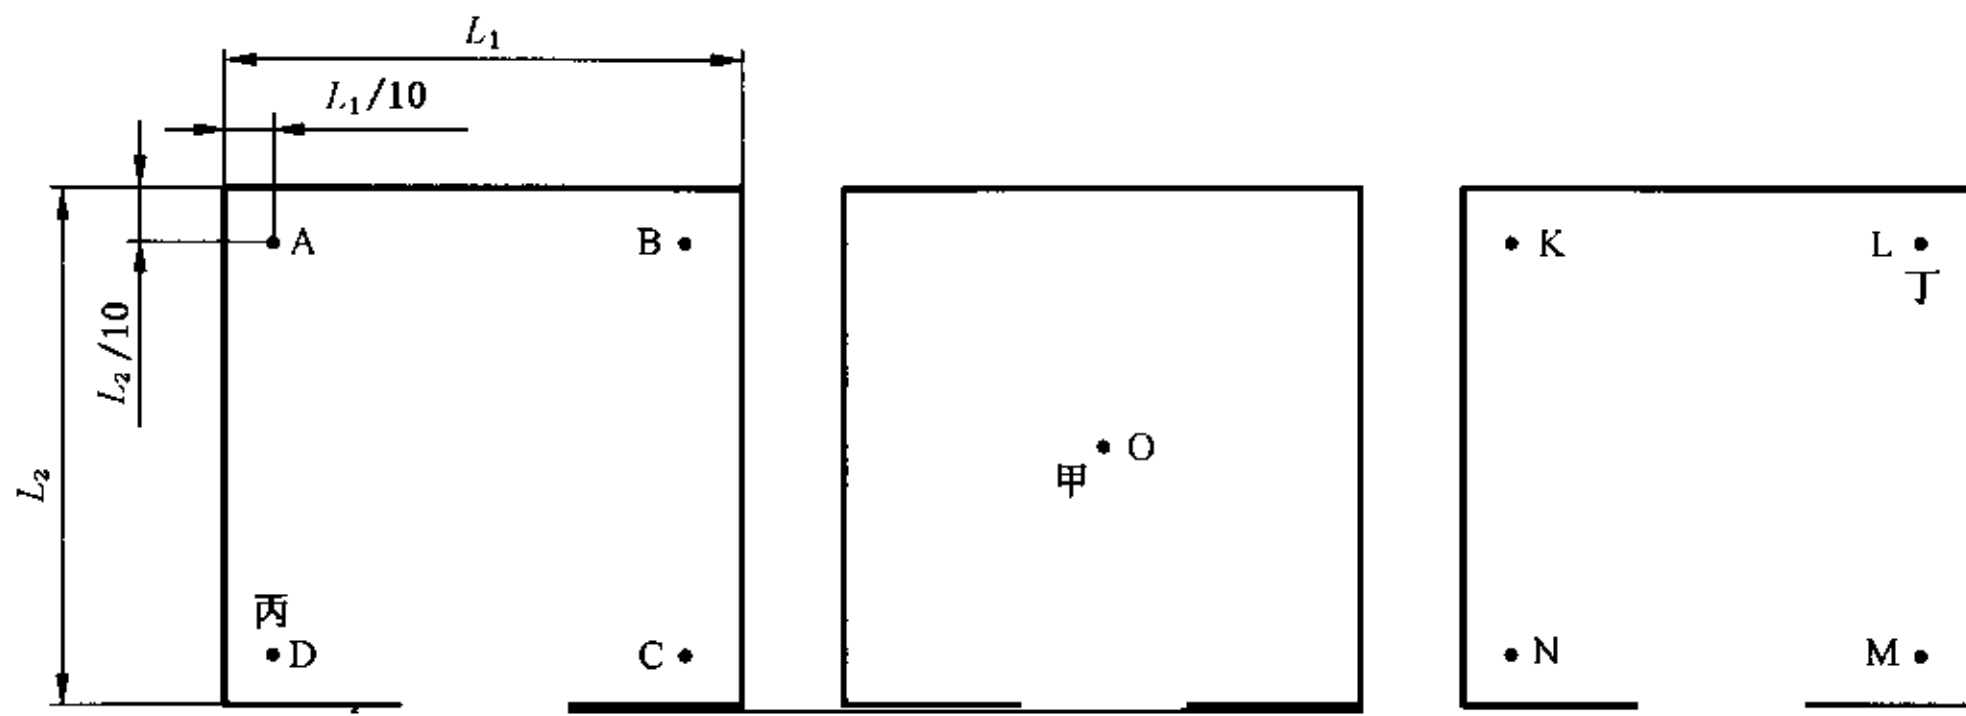

上层  
A, B, …… , M, N——温度测试点；  
甲, 丙, 丁——湿度测试点。

中层

下层



6.4.2.4 在 1h 内,使工作空间的相对湿度不低于 95%。

6.4.3.9 按式(5)计算恒温湿排试验的升沮亚柏速率

$$V_T = \frac{0.8 \times (T_2 - T_1)}{t} \dots\dots\dots (5)$$

式中:

$T_1$  具高恒沮沮度, 单位: 摄氏(°C)



7.2.2 抽样及判定规则

7.2.2.1 成批生产的试验第 批且在 20 台以上时 抽检 2 台,不足 20 台时 抽检 1 台

7.2.2.2 抽检样品经试验判定合格且无不合格品 否则 该批产品判定不合格 按 1.4.2.1 条规定执行

附录 A  
(资料性附录)  
可疑数据判别方法

附录 B  
(资料性附录)

附录 B 的标题为“附录 B 资料性附录”

.....

$II = 2 \times 11$  ..... ( B 1 )

.....

.....